


86 001

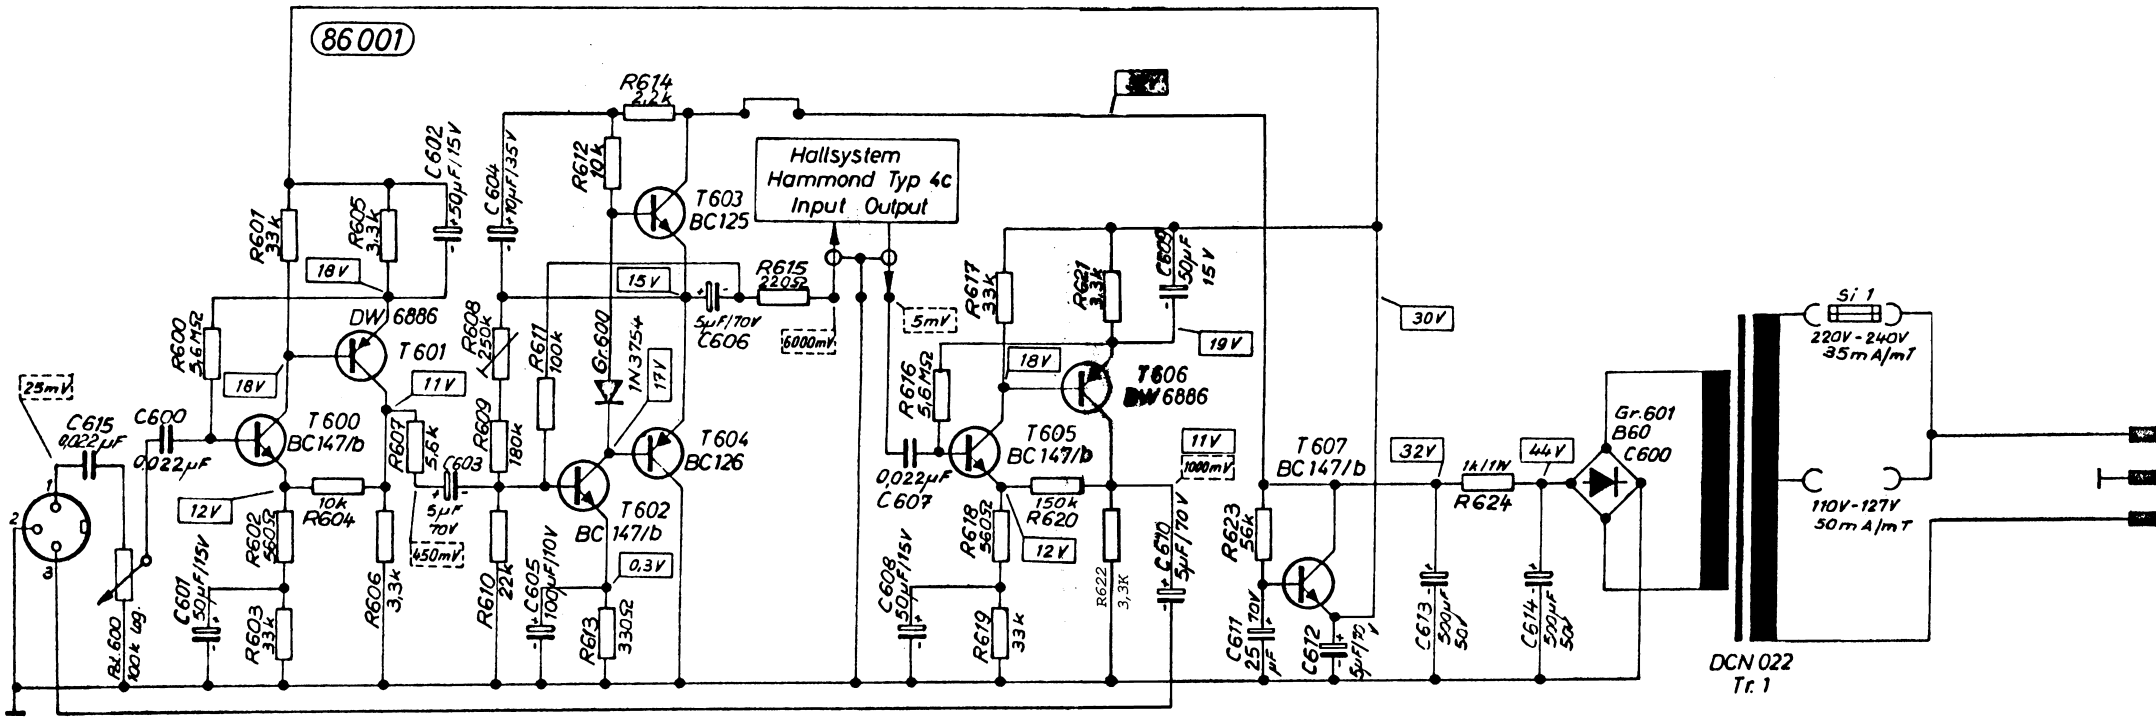


□ Gleichspannung gemessen mit Instrument 25 k $\Omega$ /V

⋯ Wechselspannung gemessen mit RVM 1kHz

# Magic-HS

Konstruktions- und Schaltungsänderungen vorbehalten!

				Tag	Name	
				Gez. 26.1.67	Tsch...	
				Gepr. 22.2.69		
				Norm.		
Magic-HS						3-0073
						Schaltbild
Änderung	Tag	Name				